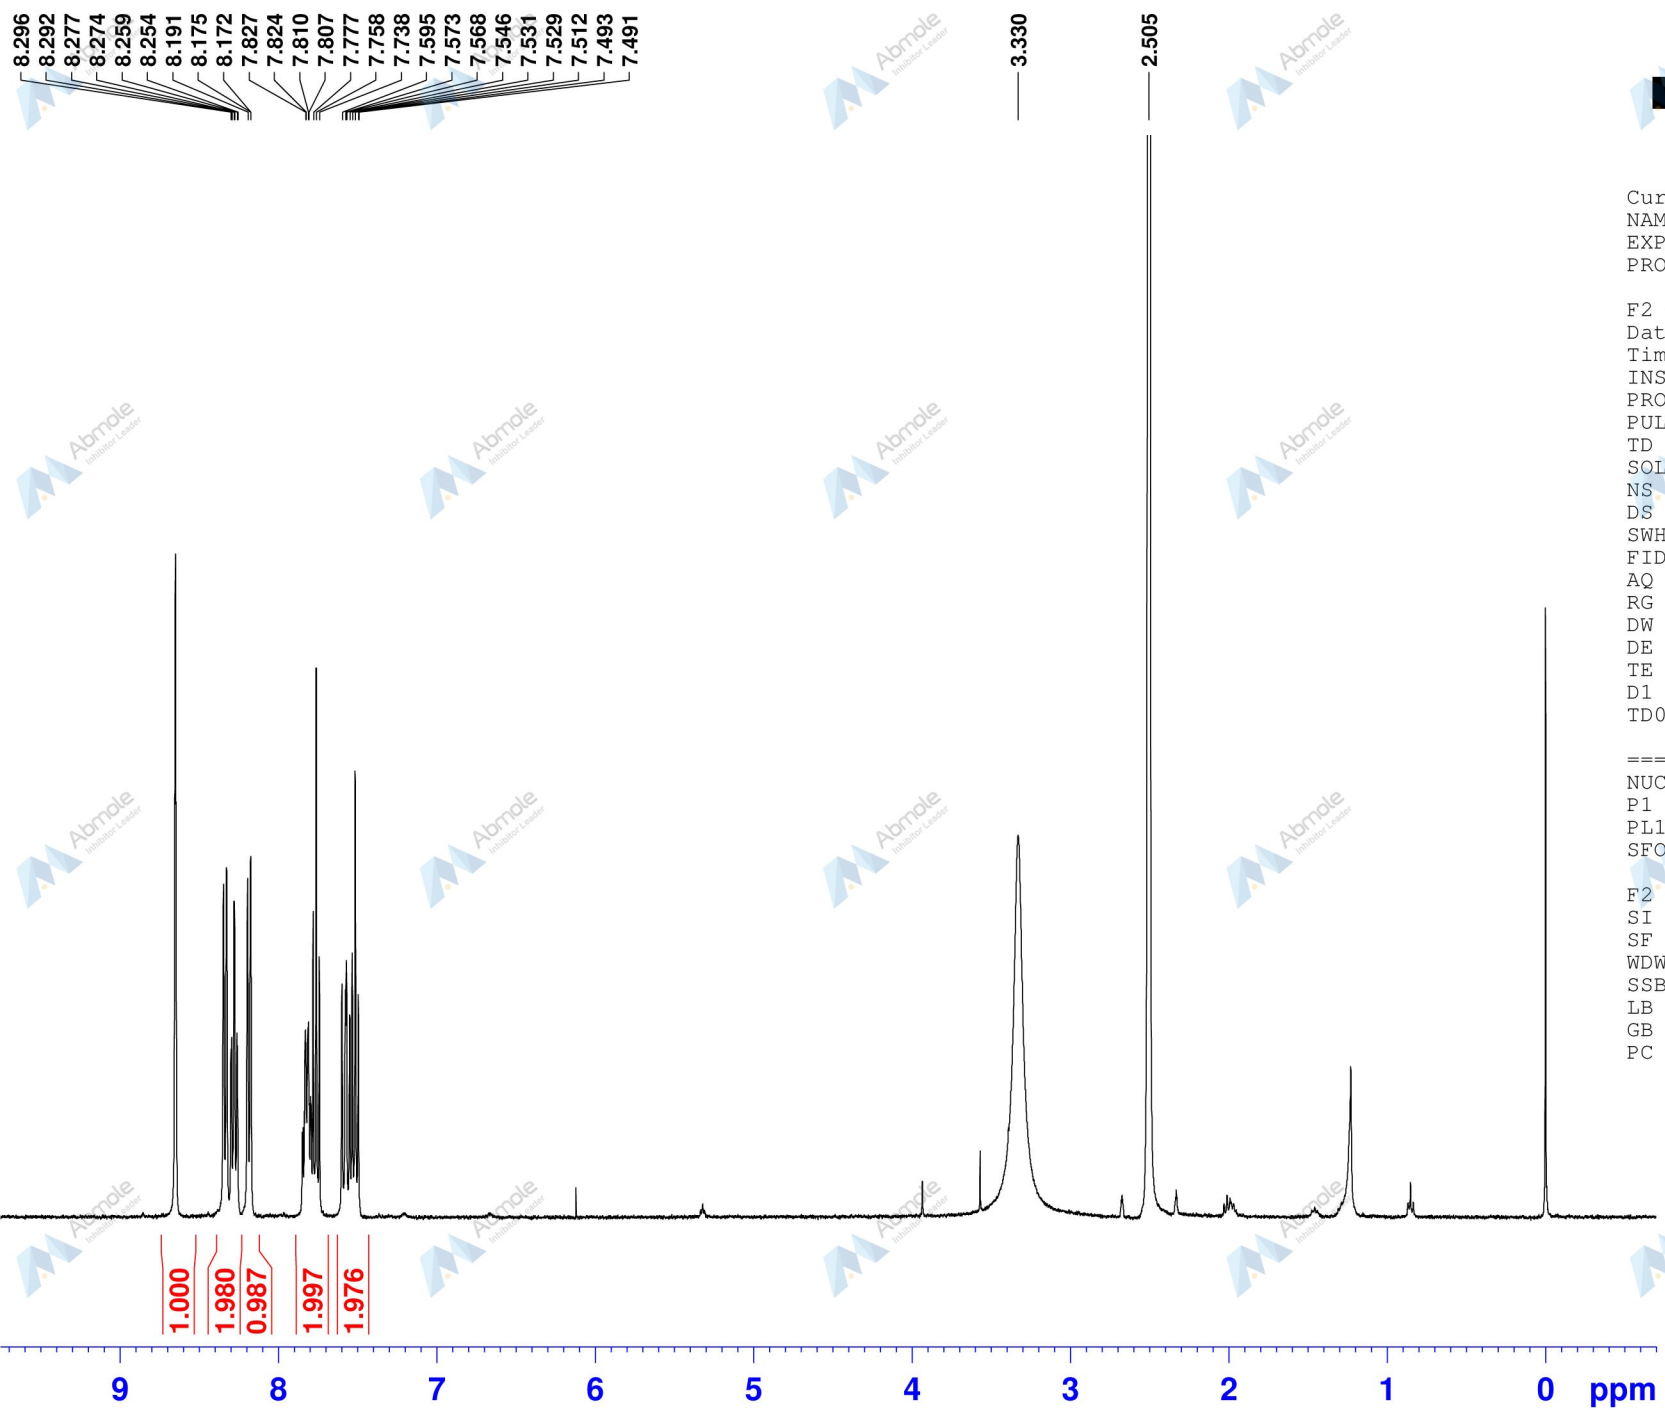

BRUKER

```
Current Data Parameters
NAME        PTC124
EXPNO                1
PROCNO               1

F2 - Acquisition Parameters
Date_         20140531
Time              9.21
INSTRUM          spect
PROBHD   5 mm PABBO BB-
PULPROG          zg30
TD              65536
SOLVENT          DMSO
NS                 16
DS                  2
SWH          8278.146 Hz
FIDRES       0.126314 Hz
AQ           3.9584243 sec
RG               456.1
DW              60.400 usec
DE               8.00 usec
TE              297.2 K
D1          1.00000000 sec
TD0                 1

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                1H
P1              10.70 usec
PL1             -3.00 dB
SFO1       400.1324710 MHz

F2 - Processing parameters
SI                32768
SF         400.1300020 MHz
WDW                EM
SSB                 0
LB               0.30 Hz
GB                  0
PC               1.00
```